medicate.

Esfigmomanômetro

Ref. MD 30

REV 09/24

Manual do Usuário
Esfigmomanômetro Aneroide

Certificado de Garantia

A obrigação da **DORJA** nos termos desta garantia consiste na substituição ou reparo de peças defeituosas, desde que o aparelho seja remetido ao seu estabelecimento diretamente ou através de revendedor autorizado.

A **DORJA** restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A **DORJA** não se responsabiliza por danos, consequências a pessoas ou a coisas em decorrência do uso do aparelho.

A **DORJA** declara nula e sem efeito a garantia se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções ou no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas.

Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Findo o prazo estabelecido para esta garantia, e somente até (12 meses manômetro) e a (06 meses demais componentes) a contar deste momento, a **DORJA** se compromete à substituição e reparo das peças defeituosas, mediante pagamento de acordo com os preços que estiverem em vigor.

A **DORJA** obriga-se a prestar os serviços acima referidos tanto os gratuítos como os remunerados,sendo o proprietário, sempre o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho.

NOTA: Esta garantia será válida se este termo for devidamente preenchido pela **DORJA** ou pelo revendedor autorizado no ato da aquisição. É necessário, ainda, que este termo, juntamente com a nota fiscal de venda, seja apresentado no instante da reclamação.

Certificado de Garantia

A ***Dorja***, assegura ao proprietário deste esfigmomanômetro marca MEDICATE, a garantia contra qualquer defeito de material e fabricação que nele se apresentar, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador comprovada pela apresentação da nota fiscal da Dorja ou de revendedor autorizado no prazo de:

MANÔMETRO: 12 MESES
DEMAIS COMPONENTES: 06 MESES

A garantia não inclui a verificação anual conforme Portaria do INMETRO 46/2016.

____/____/_____
Data

_____
Carimbo e assinatura do revendedor autorizado

Fabricado e Distribuído

DORJA

Dorja - Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda
Rua Marcos Max Guerra D'avila, 23 - Westpark Empresarial
Itu – SP - Cep. 13312-703
e-mail: sac@dorja.com.br - www.dorja.com.br
CNPJ 50.208.271/0001-05 • Indústria Brasileira

Assistência Técnica:
Consulte nossa rede de assistência técnica em anexo ou consulte nosso site: www.dorja.com.br

N° Registro Ministério Saúde 10332170031
Responsável Técnico:
Eng.Ricardo Nardelli Escobosa
CREA. 0601694023

Fabricado por: Wenzhou Hongshun Industries & Trade Co.Ltd. China

DESENHO ILUSTRATIVO

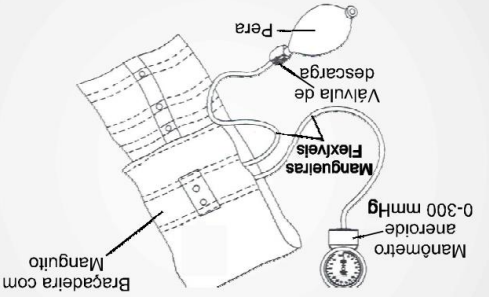

EXPLICATIVO:

Funcionamento:
A braçadeira é colocada em torno do braço sendo fechada através de fecho próprio. Através de bomba manual denominada pera, a braçadeira será insuflada até que a pressão aplicada à mesma interrompa a passagem do sangue no braço. Inicia-se então o esvazamento gradativo da braçadeira através de uma válvula. Com auxílio de um estetoscópio deve-se auscultar a artéria braquial, na junção do braço com o antebraço. A primeira batida cardíaca auscultada é a pressão sistólica (popularmente conhecida como pressão máxima), e a última batida auscultada indica a pressão diastólica (popularmente conhecida como pressão mínima).

Uso do equipamento:
Aparelho específico para medir pressão arterial.

Operação do equipamento:
Este equipamento dispensa treinamento para uso, pois é destinado a profissionais com conhecimento prévio em escolas profissionalizantes. Ex: Medicina,Enfermagem, etc...

Posicionamento da Braçadeira:
Nossa braçadeira tem uma identificação do posicionamento (uma seta com a inscrição ARTÉRIA) sendo que esta seta indica a correta colocação da braçadeira sobre a artéria braquial.

Manutenção:
A limpeza do aparelho deve ser feita com tecido suave umedecido com água (não utilizar produtos químicos agressivos) A esterilização não deve ultrapassar 60°C.
Qualquer manutenção deverá ser enviada para a Assistência Técnica.

Conseqüências do mau uso:
O mau uso do equipamento poderá provocar sérios riscos na interpretação da leitura da pressão arterial.

Defeitos	Possíveis Causas	S o l u ç ó e s
Ponteiro fora do zero (mais que 3 mmHg)	Queda Forte Descalibração	Enviar o manômetro até a Assistência Técnica para correção
Vazamento de ar	Vazamento no manômetro	Enviar o manômetro até a Assistência Técnica para correção
	Vazamento no Manguito	Comprar um manguito na sua loja de preferência e efetuar a troca, desconectando o manômetro e a pera. Em caso de garantia enviar para Assistência Técnica.
	Vazamento na Pera.	Comprar uma válvula de descarga em sua loja de preferência e efetuar a troca, desconectando o manômetro e a pera. Em caso de garantia enviar para Assistência Técnica.

MANUAL DO USUÁRIO

ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MEDICATE

Este aparelho Medicate foi verificado conforme portaria número 153/2005 do INMETRO.
Esta portaria define que todo esfigmomanômetro deve ser a verificado anualmente por um orgão competente designado pelo INMETRO.

A GARANTIA NÃO INCLUI A VERIFICAÇÃO ANUAL PELO INMETRO.

Manômetro:
Conforme indicado no Manômetro, a unidade de medição é milímetro de mercúrio (mmHg). Cada divisão corresponde a 2 mmHg e é permitido um erro no ponto Zero de 3 mmHg.

Braçadeira Tipo: Portaria Inmetro 118/2002 ☐ Velcro ☐ Botão	
TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO
Adulto	22 a 28 cm
Obeso	30 a 38 cm
Infantil	13 a 16 cm
Adolescente	16 a 20 cm
Recém Nascido	06 a 7,5 cm